

08/2018

Bartoszyce, 02.07.2018r.

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 89 675 23 05 • fax 89 764 26 25
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **08/2018**.

Nazwa zadania: „Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku..”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Część 1:

1.dotyczy zadania nr 15

Czy zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie z pakietu 15 pozycji 1 i 2 i stworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Część 2:

1.dotyczy zadania nr 32

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania czyścików w rozmiarze 4,5 x 5cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2.dotyczy § 7 ust. 1 lit b),c) wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 7 ust. 1 lit. b), c) wzoru umowy na:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- b) za zwłokę w terminie dostawy, w wysokości **0,5 %** wartości brutto niedostarczonych w terminie pozycji zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (...),
- c) za zwłokę w wykonaniu reklamacji w wysokości **0,5 %** wartości brutto reklamowanych towarów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (...),

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 5% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelných zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3. dotyczy § 8 ust. 1 lit. a), b) wzoru umowy

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę treści ww punktów na:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach:

- a) trzykrotnej, **kolejnej** zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia,
- b) zgłoszenia przez Zamawiającego trzech, **kolejnych** reklamacji złożonych na dostarczane przez Wykonawcę towary, (...)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Część 3:

1. dotyczy zadania nr 34

Z uwagi na niewłaściwe praktyki niektórych wykonawców czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 34 przedłożenia z ofertą ważnych i aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu tj. znak CE ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Część 4:

1. dotyczy zadania 01, poz.1-2

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. dotyczy zadania 01, poz.1-2

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie? Zarówno karta charakterystyki jak i oświadczenie jest wystawiane przez producenta, więc w przypadku potwierdzenia braku zawartości ftalanów w danym asortymencie oświadczenie jest dokumentem wystarczającym, natomiast karta charakterystyki

zawiera wszystkie szczegółowe dane o składzie chemicznym asortymentu, którego Zamawiający nie wymaga.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3.dotyczy zadania 02, poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4.dotyczy zadania 02, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5.dotyczy zadania 02, poz.3

Czy zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30 g/m² – 4 warstwowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6.dotyczy zadania 02, poz.2-3

Czy zamawiający dopuści wycenę za kompresy o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm x pakowane po 100 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7.dotyczy zadania 21,poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 5 szt. w pakiecie, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8.dotyczy zadania 21, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9.dotyczy zadania 21, poz. 1-3

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10.dotyczy zadania 21, poz. 1-3

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie? Zarówno karta charakterystyki jak i oświadczenie jest wystawiane przez producenta, więc w przypadku potwierdzenia braku zawartości ftalanów w danym asortymencie oświadczenie jest dokumentem wystarczającym, natomiast karta charakterystyki zawiera wszystkie szczegółowe dane o składzie chemicznym asortymentu, którego Zamawiający nie wymaga.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

11.dotyczy zadania 21, poz.3

Prosimy o wydzielenie poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

12.dotyczy zadania 22, poz.1

Czy zamawiający oczekuje kompresów włókninowych 30 G – 4 warstwowych, jałowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

13.dotyczy zadania 22, poz.1

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14.dotyczy zadania 22, poz.1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie? Zarówno karta charakterystyki jak i oświadczenie jest wystawiane przez producenta, więc w przypadku potwierdzenia braku zawartości ftalanów w danym asortymencie oświadczenie jest dokumentem wystarczającym, natomiast karta charakterystyki zawiera wszystkie szczegółowe dane o składzie chemicznym asortymentu, którego Zamawiający nie wymaga.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

15.dotyczy zadania 24, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

16.dotyczy zadania 24, poz. 5-8

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

17.dotyczy zadania 24, poz. 5-8

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18.dotyczy zadania 24, poz.5-8

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie jednostki miary, czy 1 szt= 1 mb w stanie swobodnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

19.dotyczy zadania 24, poz.5-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym, bądź za 10 mb w stanie swobodnym z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

20.dotyczy zadania 35, poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej lekkiej i przewiewnej, o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

21.dotyczy zadania 35, poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

22.dotyczy zadania 35, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

23.dotyczy zadania 39, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

24.dotyczy zadania 39, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

25.dotyczyZadania 39, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

26.dotyczy zadania 39, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pakowane w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

27.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

28.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podkładów 2-warstwowych.

29.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

30.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

31.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

32.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcionowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

33.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

34.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

35.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

36.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

37.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

38.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

39.dotyczy zadania 40, poz.1

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

40.dotyczy zadania 41, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

41.dotyczy zadania 44, poz.1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

42.dotyczy zadania 44, poz.2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

43.dotyczy zadania 44, poz.3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

44.dotyczy zadania 46, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylizowany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

45.dotyczy zadania 46, poz.1

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

46.dotyczy zadania 46, poz.1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

47.dotyczy zadania 48, poz.1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

48.dotyczy zadania 48, poz.1

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

49.dotyczy zadania 48, poz.1

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

50. dotyczy zadania 48, poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pakowane w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 5:

1. dotyczy zadania 1, 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobów sterylizowanych inną niż para wodna metodą zwalidowanej sterylizacji przemysłowej tj. tlenkiem etylenu? Zgodnie z normą dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 bezspornie wynika, że nie istnieją podstawy do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych. Ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako „sterylny” pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Czy wobec:

- braku przeciwwskazań medycznych do stosowania innej metody sterylizacji aniżeli parowa,
- braku incydentów medycznych związanych ze sterylizacją tlenkiem etylenu
- możliwości zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie złożenia ofert większej liczbie wykonawców.

Zamawiający nadal podtrzymuje warunek w postaci sterylizacji parą wodną, który narusza zasadę uczciwej konkurencji?

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania na opakowaniach wskaźnika informującego o przejściu procesu sterylizacji. O jakości zawartości opakowania informuje określenie słowne oraz symbol graficzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. dotyczy zadania 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów włókninowych 30 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. dotyczy zadania 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu, w którym 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4.dotyczy zadania 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS, posiadającego miękkie mankiety min. 6 cm? Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. W opakowaniu dodatkowo 2 rękawiczki. Odporność na przenikanie cieczy 36 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 188/170 kPa, IB – 3,2? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuchy pakowane do transportu są podwójnie w worek foliowy i karton zewnętrzny. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5.dotyczy zadania 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści by w formularzu asortymentowo-cenowym podać cenę za 1 szt. fartucha a nie za opakowanie zbiorcze ponieważ każdy rozmiar mamy pakowany w inny sposób: rozm. M-L – 52 szt., XL – 48 szt., XXL – 44 szt.? Alternatywnie – czy można podać wielkość opakowania jako średnią wyliczoną ze wszystkich rozmiarów z przeliczeniem podanych wielkości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

6.dotyczy zadania 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS, gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro przód/rękaw 259/155 kPa, odporność na rozerwanie na mokro/mokro przód/rękaw 234/144 kPa?

Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuchy pakowane do transportu są podwójnie w worek foliowy i karton zewnętrzny.

Fartuch był testowany na bloku operacyjnym i otrzymał pozytywną opinię szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7.dotyczy zadania 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści by w formularzu asortymentowo-cenowym podać cenę za 1 szt. fartucha a nie za opakowanie zbiorcze ponieważ każdy rozmiar mamy pakowany w inny sposób: rozm. S/M – 48 szt., L – 44 szt., XL – 40 szt., XXL – 36 szt.? Podanie ceny za opakowanie znacznie zawyży wartości pakietu. Alternatywnie – czy można podać

wielkość opakowania jako średnią wyliczoną ze wszystkich rozmiarów z przeliczeniem podanych wielkości opakowań.

Odpowiedź: Nie, zgodnia z SIWZ

8.dotyczy zadania 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 38 x 40 cm bez sztywnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

9.dotyczy zadania 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony przetwornika obrazu, który zawiera następujące komponenty:

- 1 szt. osłona przetwornika obrazu wykonana z folii polietylenowej,
- 2 szt. naklejka (czerwona, okrągła),
- 2 szt. elastyczna samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm

Komponenty zestawu dodatkowo owinięte w serwetę celulozowo-polietylenową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

10.dotyczy zadania 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na przewody złożonej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11.dotyczy zadania 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych 50 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

lub

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a'3szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12.dotyczy zadania 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów włókninowych w klasie Is, reguła 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13.dotyczy zadania 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów włókninowych pakowanych 75 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku? Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania na opakowaniach wskaźnika informującego o przejściu procesu sterylizacji. O jałowej zawartości opakowania informuje określenie słowne oraz symbol graficzny .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14.dotyczy zadania 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, iż gramatura wynosi 57,5 g/m², serweta na stolik Mayo złożona jest w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, zestawy pakowane do transportu są podwójnie w worek foliowy i karton zewnętrzny, taśma samoprzylepna pakowana osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

15.dotyczy Zadania 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek elastycznych pakowanych po 168 szt. w przeliczeniu, w zaokrągleniu na 41 opakowań? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16.dotyczy zadania 46

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem zakończonym gumką, gramatura 21 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Część 6:

1.dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 3 i dopuści: Gaziki z włókniny 70 G 9W niesterylne, rozmiar: 12x12,5cm, każdy gazik pakowany w hermetycznej saszetce, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

2.dotyczy zadania 15

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 15 poz. 4 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, każdy gazik pakowany w hermetycznej saszetce, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, każdy gazik pakowany w hermetycznej saszetce, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Część 7:

1.dotyczy zadania nr 14 poz.2-7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie włókninowego opatrunku pakowanego po 50 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2.dotyczy zadania nr 07, 11

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę zestawów operacyjnych za 1 zestaw i wpisanie w formularzu cenowym w kolumnie „ilość w opakowaniu” 1 z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3.dotyczy zadania nr 06

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji kończyny dolnej o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny do chirurgii kończyny dolnej - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x320cm z samouszczelniającym się owalnym otworem 5x7cm, z uchwytem („rzepem”) do mocowania kabli i drenów
- 1 serweta o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Wokół pola operacyjnego wzmocnienie o wymiarach 105 x 150cm. Odporność na rozerwanie na sucho 180kPa na mokro 170kPa. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

4.dotyczy zadania nr 07

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia II (pozycja leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Poszczególne warstwy są połączone równomiernie za pomocą kleju.

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

5.dotyczy zadania nr 09

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm bez marginesu zabezpieczającego odklejenie papieru
- 4 ręczniki 30x40cm

Odporność na rozerwanie na sucho 180kPa, na mokro: 170kPa. Wokół pola operacyjnego wzmocnienie o wymiarach 150x 60cm. Taśma mocująca min. 5cm pokryta klejem, który nie jest repozycjonowalny. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

6.dotyczy zadania nr 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na palec
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Odporność na rozerwanie na sucho 180kPa, na mokro: 170kPa.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7.dotyczy zadania nr 11 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych I - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,
- 1 serweta główna wzmocniona o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem
- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przezroczystego PE
- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Odporność na rozerwanie na sucho 180kPa, na mokro: 170kPa. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania . Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8.dotyczy zadania nr 46

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha fizelinowego, gramatura min.24g.m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 8:

1. dotyczy zadania nr 01, 21, 22

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskaźnika sterylizacji na opakowaniu (na opakowaniu znajduje się informacja o tym, że produkt jest sterylny)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. dotyczy zadania nr 06

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m ² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m ² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m ² .

Odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa, na mokro 172 kPa.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

3. dotyczy zadania nr 07

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z
--

portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m ²
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m ²
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4.dotyczy zadania nr 09

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m ²
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m ²
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m ² oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m ² .

Odporność na rozerwanie na sucho 180kPa, na mokro 172kPa.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

5.dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę z czerwonej folii polietylenowej, ze wzmocnieniem wykonanym z włókniny polipropylenowej – gramatura w strefie krytycznej 80g/m², na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne, rozmiar 80x140cm (wzmocnienie 60x140cm), pakowane a'80 szt. z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za 1 szt., pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6.dotyczy zadania nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezłatekową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² oraz dolna część serwety wykonana z folii PE.
--

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m ²
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odporność na rozerwanie na sucho 205,6kPa, na mokro 199,4kPa. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7.dotyczy zadania nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ² , zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m ²
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odporność na rozerwanie na sucho 108kPa, na mokro 95kPa. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8.dotyczy zadania nr 13, pozycja 1 – 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet o gramaturze 40g/m² Odporność na rozerwanie na sucho 50kPa, serwety posiadające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9.dotyczy zadania nr 13, pozycja 1 – 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet o gramaturze 56g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 108kPa, na mokro 95kPa, serwety posiadające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10.dotyczy zadania nr 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11.dotyczy zadania nr 14, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samoprzylepnych pasków do łączenia brzegów ran, wykonanych z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, opakowanie papier – folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12.dotyczy zadania nr 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szpatulek w rozmiarze 150 x 17 x 1,6mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13.dotyczy zadania nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 14x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14.dotyczy zadania nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ściereczki pakowane a'1 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

15.dotyczy zadania nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z trzywarstwowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m², ze szwami szytymi ultradźwiękowo, z odpornością na przenikanie cieczy 35cm H₂O i odpornością na wypychanie na sucho/mokro 150/148 kPa, pakowane papier-folia i zbiorczo w pojedynczy, mocny karton, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16.dotyczy zadania nr 19, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z trzywarstwowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m², ze szwami szytymi ultradźwiękowo, ze wzmocnieniem z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 38g/m² z przodu i na rękawach, z odpornością na wypychanie na sucho/mokro 155/150 kPa, pakowane papier-folia i zbiorczo w pojedynczy, mocny karton, opakowanie zbiorcze a'25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

17.dotyczy zadania nr 20

Czy Zamawiający dopuści produkt z 4 naklejkami do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18.dotyczy zadania nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30 x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

19.dotyczy zadania nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C aparatu RTG składającą się z trzech części:

- górna z elastyczną gumką 100x160cm
- dolna z elastyczną gumką 80cm x 150cm
- 2 taśmy przyklepne 3x100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

20.dotyczy zadania nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 40x30cm, pakowana a'1 szt. z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za 1 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

21. dotyczy zadania nr 20, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 35x120cm + 1 taśma samoprzylepna w rozmiarze 10 x 50cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa, opakowanie zbiorcze w formie pojedynczego kartonu a'100 szt., z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za sztukę, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

22. dotyczy zadania nr 21, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm z nacięciem Y pakowane a'5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

23. dotyczy zadania nr nr 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m ² . łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m ²
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m ² . łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m ²
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m ² . łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m ² i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m ² . łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m ² .

Odporność na wypychanie na sucho 125kPa, na mokro 120kPa

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie zewnętrzne karton

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

24.dotyczy zadania nr nr 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Odporność na wypychanie na sucho 110kPa, na mokro 100kPa

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

25.dotyczy zadania nr 40 - Czy Zamawiający dopuści podkłady perforowane co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

26.dotyczy zadania nr 44, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śliniaków wykonanych z bibuły powlekanej folią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

27.dotyczy zadania nr 45 - Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

28.dotyczy zadania nr 46 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL – do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

29.dotyczy zadania nr 47, pozycja 1, 3- Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

30.dotyczy zadania nr 47, pozycja 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści komplet w rozmiarze:

-powłoka 210x160cm

-poszewka 70x80cm

-prześcieradło 150x210cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

31.dotyczy zadania nr 47, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści komplet pakowany a'1 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

32.dotyczy zadania nr 47, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści komplet niesterylny

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

33.dotyczy zadania nr 47, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradła pakowane a'10 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

34.dotyczy zadania nr 47, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Część 9:

1.dotyczy zadania nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2.dotyczy zadania nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu a'200m z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

3.dotyczy zadania nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy z włókniny 30 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

4.dotyczy zadania nr 14, poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy ilość w opakowaniu a 50 sz. z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5.dotyczy zadania nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przylepny ilość w opakowaniu a 50 sz. z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

6.dotyczy zadania nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMS, trzywarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, posiadający szerokie rękawy, zapewniające swobodę ruchów. O gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. . Wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem, złożone w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, posiadający czytelne oznaczenie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu po wyjęciu fartucha z opakowania, a przed rozłożeniem.

Odporność na przenikanie cieczy 36,9cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 43,5kPa, IB – 3,0 – parametry zgodne z normą.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w karton transportowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu oraz

opakowanie typu blister, które pozwala na przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W rozmiarach M-XXL zamawiany wg potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

7.dotyczy zadania nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMS, trzywarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, posiadający szerokie rękawy, zapewniające swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m², przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach od zewnętrznej strony o gramaturze 40g/m². Wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, posiadający czytelne oznaczenie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu po wyjęciu fartucha z opakowania, a przed rozłożeniem.

Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej > 203cm H₂O, w strefie mniej krytycznej 32cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 64,8kPa, IB – 6,0

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w karton transportowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu oraz opakowanie typu blister, które pozwala na przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W rozmiarach M-XXL zamawiany wg potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

8.dotyczy zadania nr 22, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe w opakowaniu zbiorczym a'500 pakietów (2szt.) z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

9.dotyczy zadania nr 28, poz. 5, 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów, będących wyrobem niemedycznym?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

10.dotyczy zadania nr 28, poz. 5, 7:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o wyłączenie z Pakietu ww. pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zadania nr 28 poz. 5,7 do nowego zadania nr 57.

W załączeniu uaktualniony formularz cenowy.

11.dotyczy zadania nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu dwuwarstwowego 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu (materiał zgodny z normą EN 13 795 1-3, odporność na rozerwanie min. 150 kPa w obszarach niewzmocnionych i wzmocnionych)	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

12.dotyczy zadania nr 38, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne (komplet: spodnie z nogawkami bez ściągaczy + bluza z 3 kieszeniami) wykonane z włókniny niepylącej i oddychającej, typu SMS o gramaturze 45g/m², do stosowania przez personel medyczny bloku operacyjnego w kolorze niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

13. dotyczy zadania nr 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści śliniaki pakowane w op. a 100 szt. z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

14. dotyczy zadania nr 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści śliniaki foliowo-bibułowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

15. dotyczy zadania nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

serweta z workiem, folią chirurgiczną - wycięcie w folii chirurgicznej	1szt.	320x180cm
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1szt.	90x60cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk	2szt.	40x20cm

Obłożenie pacjenta wykonane z jednorodnego laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa 56g/m². Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

16.dotyczy zadania nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów TUR o składzie:

serweta z otworem elastycznym (5cm ; 4cm), ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami	1szt.	215x180cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk	2szt.	40x20cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm

Laminat dwuwarstwowy na całej powierzchni, gramatura laminatu min. 56 g/m2.
Odporność na rozerwanie na sucho i mokro min: 150 kPa.

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dispenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

17.dotyczy zadania nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologiczno-urologicznych o składzie:

serweta z otworem prostokątnym 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej	1szt.	245x180cm
serweta przeznaczona pod pośladki	1szt.	90x75cm
taśma medyczna	2szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm

serwetki do rąk	4szt.	40x20cm
-----------------	-------	---------

Obłożenie pacjenta wykonane z jednorodnego laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa oraz warstwa wiskozy o gramaturze 73g/m². Odporność na rozerwanie na sucho i mokro min: 100 kPa.

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

18.dotyczy zadania nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 240cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

19.dotyczy zadania nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

20.dotyczy zadania nr 13, poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, gramatura laminatu min. 56 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho i mokro min: 150 kPa. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

21.dotyczy zapytania dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

22.dotyczy zapytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby nr zamówienia oraz nr umowy znajdowały się na dokumencie dostawy WZ dołączonym do faktury?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby nr zamówienia oraz nr umowy znajdowały się na dokumencie WZ dołączonym do faktury.

Część 10:

1.dotyczy zadania nr 06

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kończyny dolnej o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy(współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$) o gramaturze 58g/m² odpornego na przenikanie płynów (> 200cm H₂O ,dodatkowo zaliczone testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej), odpornego na rozrywanie na mokro (≥ 200 kPa) odpornego na penetrację mikrobiologiczną na mokro- I_B 6,0. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

2.dotyczy zadania nr 07

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 µm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x kieszeń na narzędzia 33x51 cm, wykonana z mocnej folii PE, przylepna

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x250x314 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną 37x32 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x35+/- 3cm, zintegrowane 3 organizatory przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjentce, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

3. dotyczy zadania nr 07

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie,

Serwety okrywające wykonane z trilaminatu (dwie warstwy polipropylenu, jedna polietylenu) o gramaturze 66g/m², w obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne HSPP (polipropylen+polietylen) o gramaturze 144g/m², odporność na przenikanie płynów w obszarze podstawowym minimum 200cmH₂O, w obszarze krytycznym co najmniej 350cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro co najmniej 200kPa w obszarze podstawowym, zaś w obszarze krytycznym co najmniej 550kPa.

Zestaw typu SMS o gramaturze 43g/m² ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min. 115 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H₂O, a w obszarze podstawowym min. 30cmH₂O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 200 kPa, a w obszarze niewzmocnionym minimum 150 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

4.dotyczy zadania nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia na stolik w kolorze niebieskim, którego wymiary wzmocnienia wynoszą : 55cm x 88 cm .

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

5.dotyczy zadania nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym opatrunków pakowanych po :

Poz.1 -200 sztuk

Poz.2 – 100 sztuk

Poz.3- 100 sztuk

Poz.4 – 50 sztuk

Poz.5- 40 sztuk

Poz.6- 40 sztuk

Poz. 7- 40sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

6.dotyczy zadania nr 14 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków przylepnych do łączenia brzegów ran , sterylnych , hipoalergicznym o wymiarach 6mm-38 mm , opakowania jednostkowe papier-papier , opakowanie a 200 kopert x 6 pasków – z odpowiednim przeliczeniem na formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

7.dotyczy zadania nr 18

Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii transparentnej , samoprzylepnej jałowej poliuretanowej w rozmiarze :

Poz.1 10 cm x14 cm 10 sztuk w opakowaniu

Poz.2 30 cm x 28 cm 10 sztuk w opakowaniu

Poz.3 45 cm x 55 cm 10 sztuk w opakowaniu

Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręcznika białego chłonnego, wykonanego z poliestru i masy celulozowej , rozrywana torebka zawiera 2 ręczniki do rąk w rozmiarze 58 cm x 39 cm , rozłożone.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

8.dotyczy zadania nr 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE 70 μ ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

9.dotyczy zadania nr 24, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej w rozmiarze: 2,5-3,5 cm – 10 m , długość w stanie swobodnym, 25 m długość po rozciągnięciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

10.dotyczy zadania nr 24, poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej w rozmiarze: 3,5-4,5 cm – 10 m , długość w stanie swobodnym, 25 m długość po rozciągnięciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

11.dotyczy zadania nr 24, poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej w rozmiarze: 5,0-6,5cm – 10 m , długość w stanie swobodnym, 25 m długość po rozciągnięciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

12. dotyczy zadania nr 24, poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej w rozmiarze: 10,0-13,5cm – 10 m , długość w stanie swobodnym, 25 m długość po rozciągnięciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Część 11:


1. dotyczy zadania nr 01

Prosimy Zamawiającego o odstąpienia od wymogu aby na opakowaniach znajdował się indykatora sterylizacji. Indykator nie jest wymagany w zakresie wymogów zasadniczych dyrektywy WM 93/42 EWG załącznik 1 i stanowi informację dodatkową. Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2. dotyczy zadania nr 04

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawu do artroskopii barku o parametrach zgodnych z SIWZ, jednakże o następującym składzie:

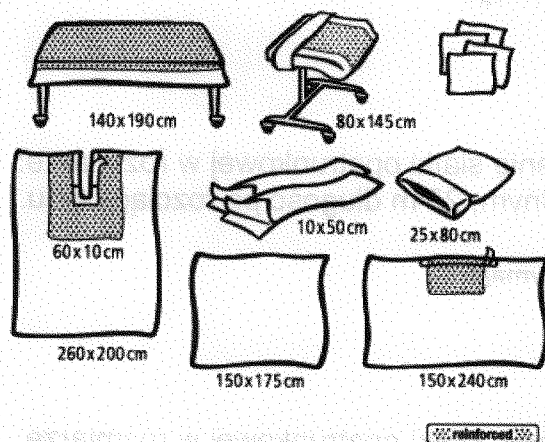

Zestaw do artroskopii stawu barkowego I wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 60 cm)	260 x 200
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240
1 osłona na kończynę	25 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

3. dotyczy zadania nr 05

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej w rozmiarze 150 x 175 cm?


Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi min. 161 kPa. Pozostałe parametry serwet bez zmian.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

4.dotyczy zadania nr 06

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji kończyny o następującym składzie:

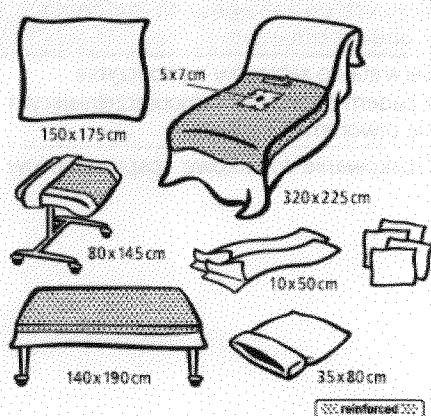

Zestaw do zabiegów na kończynie I
wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm)	320 x 225
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 osłona na kończynę	35 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Gramatura laminatu podstawowego 55g/m². Łata chłonna o rozmiarze 105 x 150cm ma gramaturę 110g/m².

W części podstawowe odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi 161 kPa, w części wzmocnionej wartość zgodna z SIWZ. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

5.dotyczy zadania nr 07

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta dwuwarstwowa PP/PE do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm


- 1 serweta dwuwarstwowa PP/PE do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

6. dotyczy zadania nr 08

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do zabiegów na kończynie:

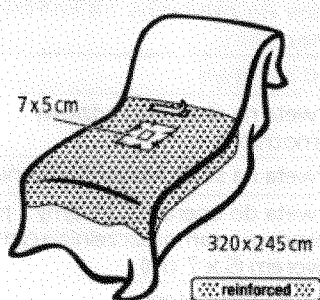

Serweta do zabiegów na kończynie
z padem chłonnym

Serweta do zabiegów na kończynie
z padem chłonnym i samouszczelniającym
się otworem Ø 7 x 5 cm

245 x 320

Opakowanie dodatkowe - papier krepowy


Gramatura laminatu podstawowego 55g/m². Łata chłonna o rozmiarze 105 x 150cm ma gramaturę 110g/m².

W części podstawowe odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi 161 kPa, w części wzmocnionej wartość zgodna z SIWZ. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

7. dotyczy zadania nr 11

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR o następującym składzie:

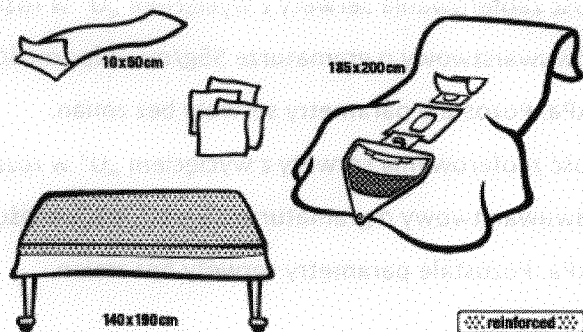

Zestaw do operacji urologicznych I


Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum	185 x 200
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Gramatura laminatu dwuwarstwowego 55g/m². Odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi min.

161 kPa, Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologiczno-urologiczny następującym składzie:

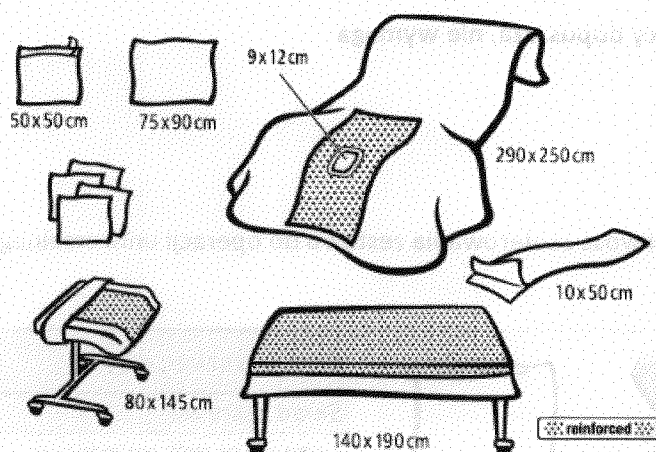

Zestaw ginekologiczny II wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm)	290 x 250
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki	75 x 90
1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu	50 x 50
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Gramatura laminatu podstawowego 55g/m². Łata chłonna w serwecie głównej o rozmiarze 50 x 140cm

ma gramaturę 110g/m².

W części podstawowe odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi 161 kPa, w części wzmocnionej wartość zgodna z SIWZ. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

8.dotyczy zadania nr 12

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z wycięciem „U” w rozmiarze 225 x 280 cm (wycięcie 10 x 95cm)? Laminat dwuwarstwowy o gramaturze 55g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi 161 kPa. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z wycięciem „U” w rozmiarze 150 x 200 cm (wycięcie 10 x 60cm)? Laminat dwuwarstwowy o gramaturze 55g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi 161 kPa. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

ZADANIE NR 13

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 150 x 175 cm?





Poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro wynosi min. 161 kPa.

Pozostałe parametry serwet bez zmian.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

9.dotyczy zadania nr 23

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji uniwersalnego o następującym składzie:

Zestaw uniwersalny II	
Skład zestawu:	
	1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190
	1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145
	1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240
	1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175
	2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90
	1 taśma samoprzylepna 10 x 50
	4 ręczniki celulozowe 30 x 33

Gramatura laminatu dwuwarstwowego 55g/m². Warstwa chłonna w stoliku Mayo ma rozmiar 60 x 145cm.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

9.dotyczy zadania nr 05,07,08,11,12,13,29

Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawów operacyjnych za 1 zestaw i wpisanie w formularzu cenowym w kolumnie „ilość w opakowaniu” 1 z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 12:

1.dotyczy zadania nr 07

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 50 x 80cm;
- 1 kieszeń dwukomorowa 30 x 40cm
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50
- 1 serweta główna w kształcie litery T 250/150 x300cm z otworem 35x35cm wypełnionym folią chirurgiczną,
- zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (szybownik), 2 zawory
- odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
- Opakowanie wyposażone w 4 naklejki do dokumentacji medycznej

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

2.dotyczy zadania nr 09

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o poniższym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90cm
- 1 serweta 150 x 200cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny
- 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w
- rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia
- Opakowanie wyposażone w 4 naklejki do dokumentacji medycznej

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

3.dotyczy zadania nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuch chirurgicznego z szerokim rękawem z pojedynczym szwem , bez pośredniego opakowania kartonowego pełniącego funkcję dyspensera. Opakowanie jednostkowe wyposażone w 3 naklejki do dokumentacji medycznej? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

4.dotyczy zadania nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuch chirurgicznego bez pośredniego opakowania kartonowego pełniącego funkcję dyspensera. Opakowanie jednostkowe wyposażone w 3 naklejki do dokumentacji medycznej? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

5.dotyczy zadania nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuch chirurgicznego z szerokim rękawem z pojedynczym szwem , posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m2, bez pośredniego opakowania kartonowego pełniącego funkcję dyspensera. Opakowanie jednostkowe wyposażone w 3 naklejki do dokumentacji medycznej? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

6.dotyczy zadania nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuch chirurgicznego posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m2, bez pośredniego opakowania kartonowego pełniącego funkcję dyspensera. Opakowanie jednostkowe wyposażone w 3 naklejki do dokumentacji medycznej? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

7.dotyczy zadania nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z 2 szt. taśmy OP, serwetą na stół instrumentarium chłonną na całej powierzchni bez dodatkowego wzmocnienia oraz z 4 szt. ręczników celulozowych do rąk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

8.dotyczy zadania nr 36, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9.dotyczy zadania nr 36, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10.dotyczy zadania nr 36, poz. 5-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sukienki jednorazowej tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11.dotyczy zadania nr 40,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z perforacją co 37-50cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

12.dotyczy zadania nr 47, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli o poniższym składzie:

- poszwa: 210x 160cm
- prześcieradło: 210x160cm
- powłoczka: 70x80

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

13.dotyczy zadania nr 47, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli o poniższym składzie:

- poszwa: 210x 160cm
- prześcieradło: 210x160cm
- powłoczka: 70x80
- gramatura: 30g/m2

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

14.dotyczy zadania nr 47, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli o poniższym składzie:

- poszwa: 210x 160cm
- prześcieradło: 210x160cm

- powłoczka: 70x80

-gramatura: 20g/m2

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

15.dotyczy zadania nr 47, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nie sterylne komplety pościeli o poniższym składzie:

- poszwa: 210x 160cm

- prześcieradło: 210x160cm

- powłoczka: 70x80

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Część 13:

1.dotyczy zadania nr 4, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 5 x 7,5 cm zamiast 5 x 7,2 cm w opakowaniu a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2.dotyczy zadania nr 4, poz. 2-3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm w opakowaniu a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

3.dotyczy zadania nr 4, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w opakowaniu a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

4.dotyczy zadania nr 4, poz. 7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x30 cm, zamiast 10x35 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga


5.dotyczy zadania nr 4, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

6.dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem na kaniulę, jak na rysunku poniżej?

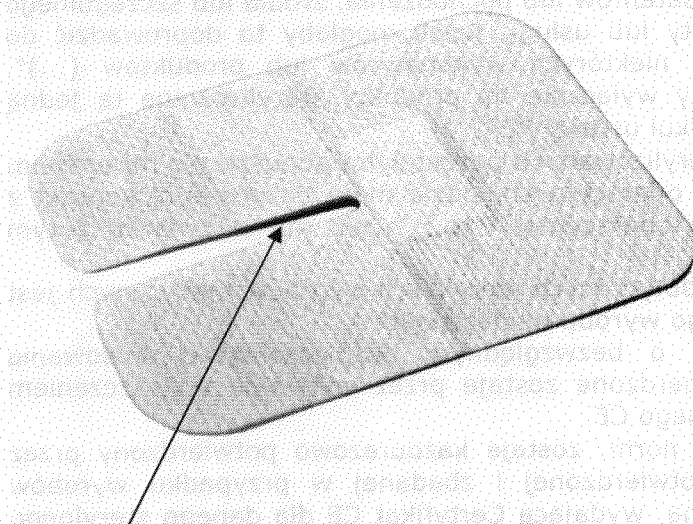

Wycięcie

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Część 14:

1.dotyczy zadania nr 34 pozycje 1,2

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

2.dotyczy zadania nr 34 pozycje 1,2

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Część 15:

1.dotyczy zadania nr 01, 21

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi, dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą (art. 29): "przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (...)". Ograniczając możliwość złożenia oferty wyłącznie na produkty sterylizowane tą jedną metodą Zamawiający narusza w/w artykuł ustawy PZP.

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych pozostałymi dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań.

Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego.

Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE.

Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2.dotyczy zadania nr 02 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

3.dotyczy zadania nr 04 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 04 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Skład zestawu:

1. 1 serweta na stół instrumentariuszki, wzmocniona, 150x190 cm
2. 1 serweta samoprzylepna, wzmocniona 230x260 cm z wycięciem U o wymiarze 20x85cm wykończonym taśmą samoprzylepną
3. 1 serweta pomocnicza 100x150 cm
4. 1 serweta samoprzylepna ze wzmocnieniem 150x300
5. 1 osłona na kończynę o wym. 36x120 cm
6. 2 taśmy samoprzylepne 9x50 cm

7. 1 osłona wzmocniona na stolik Mayo

- materiał serwet spełnia wymogi normy EN 13795 1-3
- materiał składa się minimum z dwóch warstw (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa), o min gramaturze materiału na całej powierzchni 60g/m² + dodatkowy pad : w częściach wzmocnionych o gramaturze całkowitej 140g/m²
- odporność na przenikanie płynów powyżej 165 cm H₂O w obszarach niewzmocnionych
- odporność na rozerwanie 168 kPa w obszarach niewzmocnionych i 168 kPa w obszarach wzmocnionych
- niepyłące, niezawierające lateksu
- produkty posiadają informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym
- posiadają oznaczenia CE
- sterylne, z okresem przydatności min. 1 rok od daty dostawy
- wszystkie opisy na opakowaniach zbiorczych i jednostkowych są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych w języku polskim
- zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

4. dotyczy zadania nr 04 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 04 poz. 1 zestawów w opakowaniu zawierającym 4 sztuki w ilości 4 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

5. dotyczy zadania nr 04 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 04 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do chirurgii odbytnicy :

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm,
- 1 serweta z samoprzylepnym oknem w okolicy jamy brzusznej (25 cm x 30 cm) i otworem w okolicy odbytu (9 x 15 cm) z dodatkową osłoną do zasłaniania otworu, kiedy nie jest używany, zintegrowana z nogawicami i kieszenią z filtrem i portem, w rozmiarze 335 cm x 220/240 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78 cm x 145 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm .
- 2 ręczniki celulozowe 30,5 cm x 34 cm
- materiał serwet spełnia wymogi normy EN 13795 1-3
- materiał składa się z dwóch warstw (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa), o min gramaturze materiału na całej powierzchni 60g/m²
- odporność na przenikanie płynów powyżej 165 cm H₂O w obszarach niewzmocnionych

- odporność na rozerwanie 168 kPa w obszarach niewzmocnionych i 168 kPa w obszarach wzmocnionych
- niepyłące, niezawierające lateksu
- produkty posiadają informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym
- posiadają oznaczenia CE
- sterylne, z okresem przydatności min. 1 rok od daty dostawy
- wszystkie opisy na opakowaniach zbiorczych i jednostkowych są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych w języku polskim
- zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

6.dotyczy zadania nr 05

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 niżej opisanych serwet?

Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa, nieprzylepna. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu 60 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, na mokro 168 kPa

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Serweta posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu.

Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dispenser oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

7.dotyczy zadania nr 05

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 05 serwet w opakowaniach:

Poz. 1 – 6 opakowań a'45 sztuk

Poz. 2 – 3 opakowania a'60 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

8.dotyczy zadania nr 06

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 06 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie)

4 ręczniki 30,5 x 34 cm

1 wzmoniczniona serweta na stolik Mayo 78 x 145 cm

2 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

1 osłona na kończyne 36x65cm

1 serweta na kończynę dwuwarstwowa 230x300 cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym, z elastycznym otworem 7 cm, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, na mokro 168 kPa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 75x80cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

9.dotyczy zadania nr 06

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 06 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie)

4 ręczniki 30,5 x 34 cm

1 wzmocniona serweta na stolik Mayo 78 x 145 cm

2 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

1 serweta przylepna 75x90cm

1 serweta na kończynę trzywarstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 230x300 cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym, z elastycznym otworem 7 cm, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta: 2 x włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 75 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 314 kPa, na mokro 290 kPa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 50x100cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 155 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

10.dotyczy zadania nr 07

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopiniowanie w zadaniu nr 07 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie)

4 ręczniki do rąk 30,5x34cm

1 wzmocniona serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 75 cm x 120 cm

2 taśmy mocujące 9x50cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 186/250 cm x 330 cm z otworem folią operacyjną 36x36 cm w obszarze jamy brzusznej z otworem 18x16cm z workiem do zbiórki płynów 360 stopni.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie. Ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej.

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Ilość: 30 opakowań zawierających 2 dyspensery a'5 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

11.dotyczy zadania nr 09

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopiniowanie w zadaniu nr 09 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie)

1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm (wzmocniona włókniną oraz laminatem dwuwarstwowym)

2 x taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x300cm z dodatkową warstwą chłonną

1 serweta operacyjna 100x150cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 36x120cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 230 cm x 260 cm z wycięciem "U" 20 cm x 85 cm z dodatkową warstwą chłonną i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, na mokro 168 kPa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych samoprzylepnych pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

12.dotyczy zadania nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 11 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie)

1 ręcznik 30,5 x 34 cm

1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 30 cm

1 taśma mocująca 9x50cm

1 serweta do procedur TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm

Laminat dwuwarstwowy na całej powierzchni, gramatura laminatu 60 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, na mokro 168 kPa

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu) Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Ilość: 21 opakowań zawierających 2 dyspensery a 6 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

13.dotyczy zadania nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 11 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie)

2 ręczniki 30,5 x 34 cm

1 rzep do mocowania przewodów 2,5 x 30cm

1 serweta pod pacjenta dwuwarstwowa 60 x 120 cm z otworem 9x12cm i torebką na płyny

1 serweta dwuwarstwowa do ginekologii 270/230 x 260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy odbytu 24x21 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo

Laminat dwuwarstwowy na całej powierzchni, gramatura laminatu 60 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, na mokro 168 kPa

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu) Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Ilość: 21 opakowań zawierających 2 dyspensery a'6 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

14.dotyczy zadania nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 poz. 1 niżej opisanych serwet?

Sterylna serweta 230x240 z wycięciem U 10x100cm, posiadająca samoprzylepny obszar wokół wycięcia o szerokości 5 cm. Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta (2 x włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu 75 g/m². Serweta posiada dodatkowe wzmocnienie chłonną o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części wzmocnionej 155g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 314 kPa, na mokro 290 kPa

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Serweta posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu) Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojedyncze serwety pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Ilość: 8 opakowań zawierających 2 dyspensery a'8 serwet

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

15.dotyczy zadania nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 poz. 2 niżej opisanych serwet?

Sterylna serweta 150x250cm z wycięciem U 7x70cm, posiadająca samoprzylepny obszar wokół wycięcia o szerokości 5 cm Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu 60 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, na mokro 168kPa

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Serweta posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu) Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojedyncze serwety pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Ilość: 2 opakowania zawierające 4 dyspensery a'8 serwet

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

16.dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopferowanie w zadaniu nr 17 opatrunków pakowanych po 50sztuk w ilości 920 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

17.dotyczy zadania nr 19 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy >40cm H₂O i wskaźniku IB=2,9. Fartuchy bez wzmocnienia nie posiadają tak wysokiego parametru IB, jak opisuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

18.dotyczy zadania nr 19

W związku z różnym (niżej opisanym) sposobem pakowania, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wycenę fartuchów chirurgicznych za sztukę.

Rozmiar M, L – 20 sztuk fartuchów w opakowaniu

Rozmiar XL, XXL – 18 sztuk fartuchów w opakowaniu

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

19.dotyczy zadania nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopferowanie kompresów w opakowaniu papier-papier, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

20.dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopferowanie dostarczanych obecnie kompresów w opakowaniu papier-papier, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

21.dotyczy zadania nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaopferowanie w zadaniu nr 23 niżej opisanego (nieznacznie różniącego się), dostarczanego obecnie zestawu?

serweta z przylepcem 1 szt 240x150

serweta z przylepcem 1 szt 180x180

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 szt 90x75

taśma medyczna 1szt 50x9

serweta na stół instrum. 1 szt 190x150 (z dodatkowym wzmocnieniem min.190 x 75)

serweta na stolik Mayo 1 szt 145x78 (złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z warstwą chłonna min 85 x 65 cm)

serwetki do rąk 2 30,5x34cm

- materiał serwet bezwzględnie spełnia wymogi wysokie normy EN 13795 1-3

- materiał składa się z dwóch warstw na całości (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa), o gramaturze materiału na całej powierzchni 60 g/m²

- odporność na na wypychanie na sucho i mokro 168 kPa

- produkty posiadają informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym

- posiadają oznaczenia CE

- sterylne, z okresem przydatności min. 1 rok od daty dostawy

- wszystkie opisy na opakowaniach zbiorczych (pakowanych w dwa kartony z czego jeden służy jako dyspenser) i jednostkowych powinny być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych w języku polskim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Część 16:

1.dotyczy zadania nr 40

czy w zadaniu nr 40 Zamawiający wymaga podkładów jedno- czy dwuwarstwowych? Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji podkład z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podkładów 2-warstwowych, Zamawiający dopuszcza podkłady z perforacją co 37,5cm.

Część 17:

1.dotyczy zadania nr 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 40 podkładów z perforacją co 37cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2.dotyczy treści SIWS

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

1. Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. X pkt 10 SIWZ.

Część 18:

1.dotyczy zadania nr 28, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z dwóch zestawów:

Zestaw A – będący wyrobem medycznym o składzie:

Serweta na stół narzędziowy włókniny foliowanej 150 cm x 90cm	1szt
Pokrowiec na kończynę dolną z włókniny polipropylenowej 120 x 80 cm	1 szt.
Tufery kule 30 x 30 cm 17 N	5 szt
Kompresy włókninowe 40 g/m ² 4W 10 cm x 20 cm	5 szt
Kompresy włókninowe 40 g/m ² 4 W 7,5 cm x 7,5 cm	10szt
Nożyczki do cięcia pępowiny 12,5 cm	1 szt.
Zaciski na pępowinę	2 szt.
Podkład Chłonny typu Seni Soft 90 x 60 cm	1 szt.
Serweta z włókniny kompresowej 40 g/m ² 80 cm x 60 cm	1 szt.
Nożyczki do cięcia krocza 18 cm	1 szt.
Korczang plastikowy jednorazowy 24 cm	1 szt.
Nerka tekturowa na łożysko	1szt
Rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar M	2 szt.

Zestaw B będący wyrobem niemedyceznym o składzie:

Flanek dla dziecka 160 x 75 cm	1 szt.
Czapeczka	1 szt.
Centymetr do mierzenia noworodka	1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2. dotyczy zadania nr 28, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z dwóch elementów:

Zestaw A – będący wyrobem medycznym o składzie:

Serweta z włókniny kompresowej 40 g/m ² 80 cm x 60 cm	4 szt.
Podkład Chłonny typu Seni Soft 90 x 60 cm	1szt
Zaciski na pępowinę	1szt

Serweta włókniny foliowanej 75 cm x 90cm	1szt
--	------

oraz dodatkowo czapeczka 1 szt. (wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający jednocześnie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert. **Nowy termin to: 05.07.2018r., do godz. 11:00.** Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:

-uaktualniony formularz cenowy

Z-GA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
.....
Kierownik zamawiającego
02.07.2018r.